

OLYMPUS

Příloha č.3

Česká verze informačního schématu přípravy přístroje k čištění (E0429476_TJF-180V_Plastic_Sheet_070113)

OLYMPUS



Your Vision, Our Future


TJF TYP Q180V


Lékařská endoskopie


Manuální čištění vašeho TJF-Q180V


TJF-Q180V má několik konstrukčních změn, které umožňují snadnější čištění. Tento rychlý průvodce poskytuje přehled hlavních zdokonalení procesu manuálního čištění.


-  **Distální čepičku**, na rozdíl od předchozích typů, NELZE sundat. Je nedílnou součástí čistícího konce
-  **Ovládací lanko Albaranova můstku** je nyní pevně utěsněno, tedy na ovládací části již NENÍ připojení čištění tohoto lanka


-  **Kartáček MH-507** používejte standardně vždy po použití endoskopu pro čištění prostoru můstku, a současně pro čištění přední a zadní strany můstku



-  **Kartáček MAJ-1888** je doporučen pro čištění při velkém znečištění prostoru můstku. Umožňují hlubší přístup do prostoru pod můstkem. Postupujte podle obrázků :

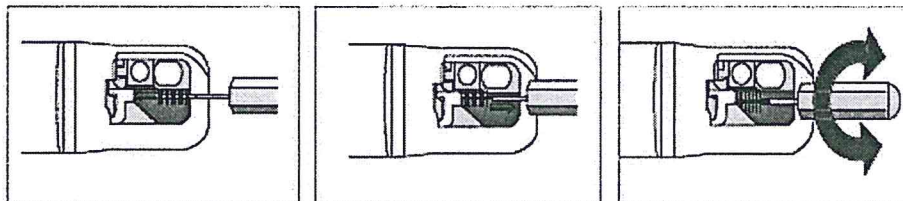

-  **Před vložením do dezinfekčních automatů** nastavte můstek do polohy 45°. To umožní optimální mytí a dezinfekci obou stran můstku



Tento leták slouží pouze pro rychlou orientaci. Podrobnější instrukce o dekontaminaci jsou uvedeny v návodu na dekontaminaci TJF-Q180V.

*Číslo výrobku není uvedeno, protože výrobek je určen pouze pro zdravotnické účely a není určen k obecnému použití.

OLYMPUS

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH
Postfach 14 49 04, 21034 Hamburg, Germany
Wendekabasse 14-18, 22017 Hamburg, Germany
Phone: +49 (0)41 237 750, Fax: +49 (0)41 230 761
www.olympus-europe.com



Verz. 1.1.2014
070113

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, Evropská 176/16, 160 41 Praha 6 - Vokovice, (OCS)
zápis v ORMS v Praze, oddíl C, vložka 93921, IČ 27068641, DIČ CZ27068641; www.olympus.cz;

tel. 221 985 211, 221 985 111, centrální fax: 221 985 505, fax (spotř.zb.) 221 985 593,
fax (endo) 221 985 569, fax (diag.) 221 985 414, fax (mikro) 221 985 579

tuv
CERT
ISO 9001:2000
Certifikát: 01 100 08017/113